

Abgangsbogen VITUS DN 15



Ø 15 / 150 mm x 100 mm
25 667 06 99

Ø 15 / 500 mm x 100 mm
25 668 06 99

- Ⓓ **Montageanleitung**
- Ⓐ **Montagehandleiding**
Uitgangsbocht VITUS DN 15
- Ⓕ **Instructions de montage**
Coude de sortie VITUS DN 15
- Ⓖ **Assembly instructions**
Outlet elbow VITUS DN 15
- Ⓔ **Instrucciones de montaje**
Codo de salida VITUS DN 15 de SCHELL
- Ⓗ **Szerelési útmutató**
VITUS DN 15 csatlakozó könyök

DOMO®

Made in Germany

 **SCHELL**



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

- (D)** VITUS Zubehör: Neuinstallation mit Abgangsbogen (150 / 500 mm)
(NL) VITUS toebehoren: Nieuwe installatie met afvoerbochtstuk (150 / 500 mm)
(F) Accessoires VITUS : Nouvelle installation avec coude de sortie (150 / 500 mm)
(GB) VITUS accessory: New installation with outlet elbow (150 / 500 mm)
(E) Accesorio VITUS: Nueva instalación con codo de salida (150 / 500 mm)
(HU) VITUS tartozék: Újraszereles csatlakozó könyökkel (150 / 500 mm)

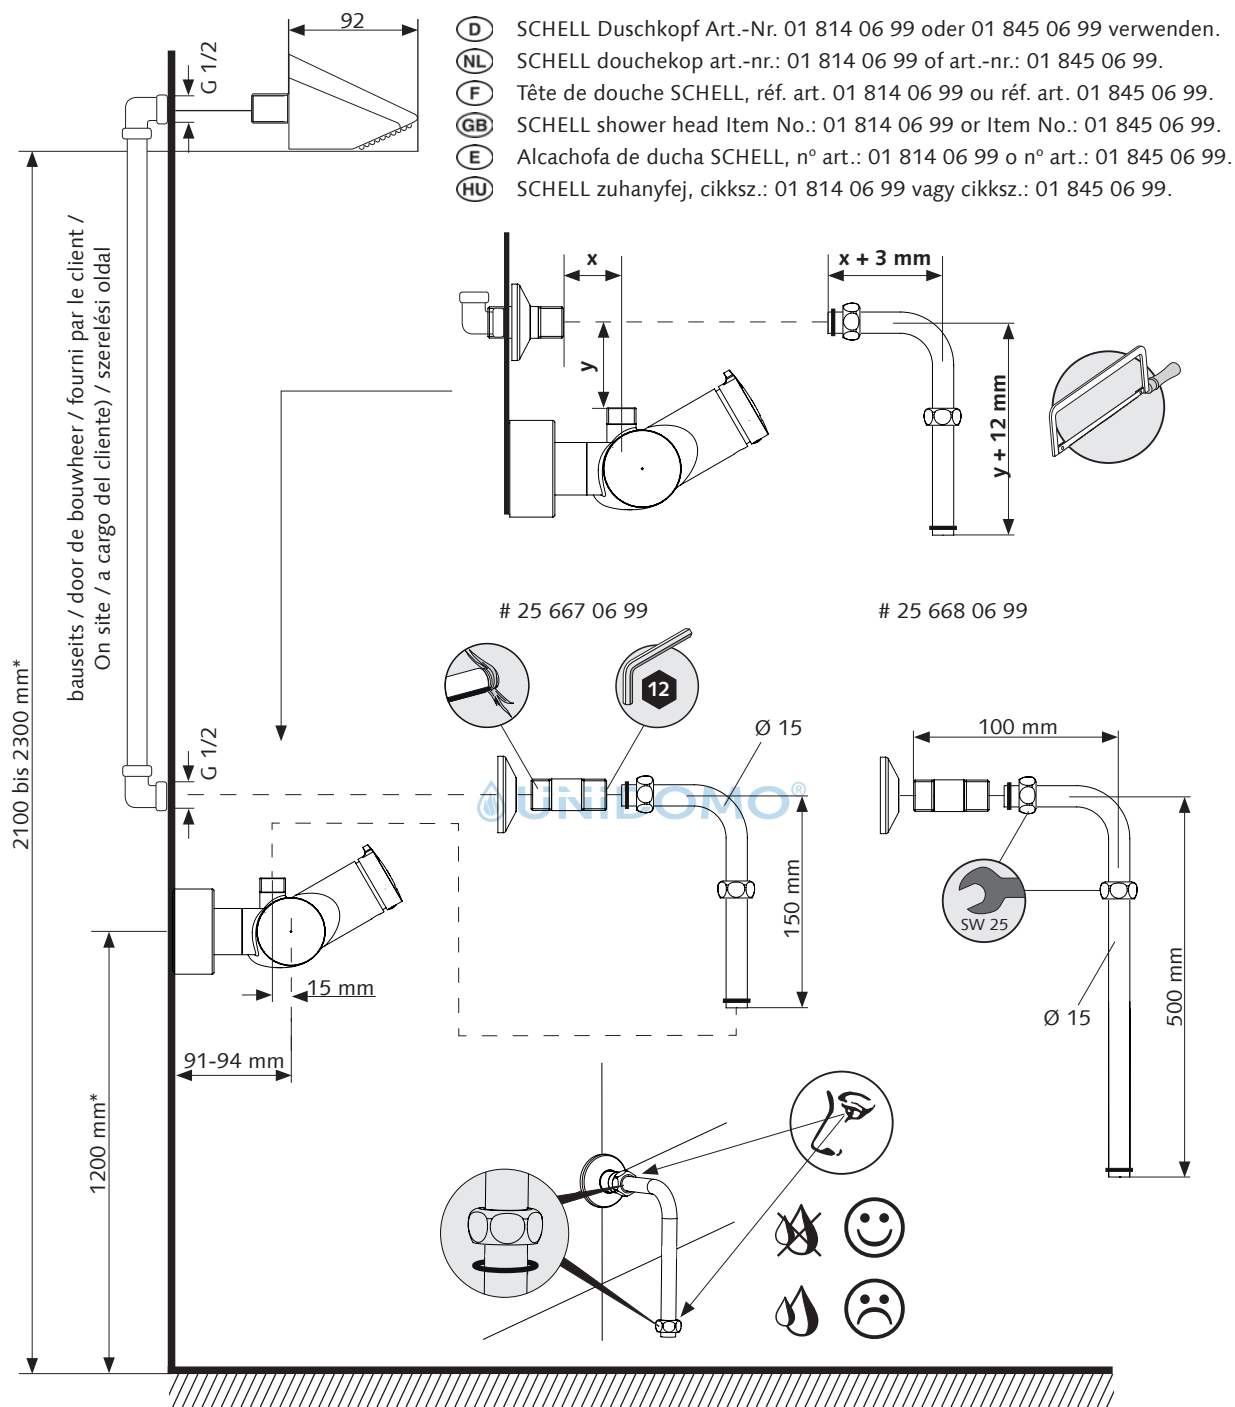

- (D)** *Empfohlene Einbaumaße. Abweichende Installationsmaße bei Einrichtungen die hauptsächlich von Kindern oder sitzend (Pflegebereich) genutzt werden beachten.
(NL) *Aanbevolen installatiematen. In acht nemen bij voorzieningen die hoofdzakelijk door kinderen of zittend (verzorgingssector) worden gebruikt.
(F) *Respecter les cotes de montage différentes en cas d'installations destinées principalement aux enfants ou à des personnes assises (domaine des soins).
(GB) *Observe alternative installation measurements for facilities primarily used by children or when sitting (care sector).
(E) *Medidas de montaje diferentes en instalaciones que vayan a ser utilizadas principalmente por niños o personas que necesiten sentarse (área asistencial).
(HU) *Figyeljen az ettől eltérő szerelési méretekre az olyan berendezéseknél, amit főként gyermekek használnak, vagy ülve történő használatra kell kialakítani (betegápolás).